Configurar dispositivo BioPad – Web

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608


Configurar un dispositivo BioPad con Siigo NOI Asistente desde la versión web permite establecer la comunicación necesaria para utilizarlo en el registro de asistencia. Realiza este proceso cuando incorpores un nuevo equipo, ya que primero deberás preregistrarlo, preparar su conexión y posteriormente activarlo para comenzar a utilizarlo.

1. Verifica los requisitos del dispositivo

Antes de iniciar, confirma que el modelo BioPad sea compatible con Siigo NOI Asistente y que cumpla con las condiciones necesarias de hardware, software y conectividad.

2. Preregistra el dispositivo


Desde Siigo NOI Asistente, ingresa a **Configuración** , selecciona **Dispositivos** 

y haz clic en **Agregar** 

para abrir la ventana de **Preregistro**.




Selecciona **Reloj checador de la empresa** y, en **Tipo de reloj checador**, elige **Dispositivo biométrico BioPad**.

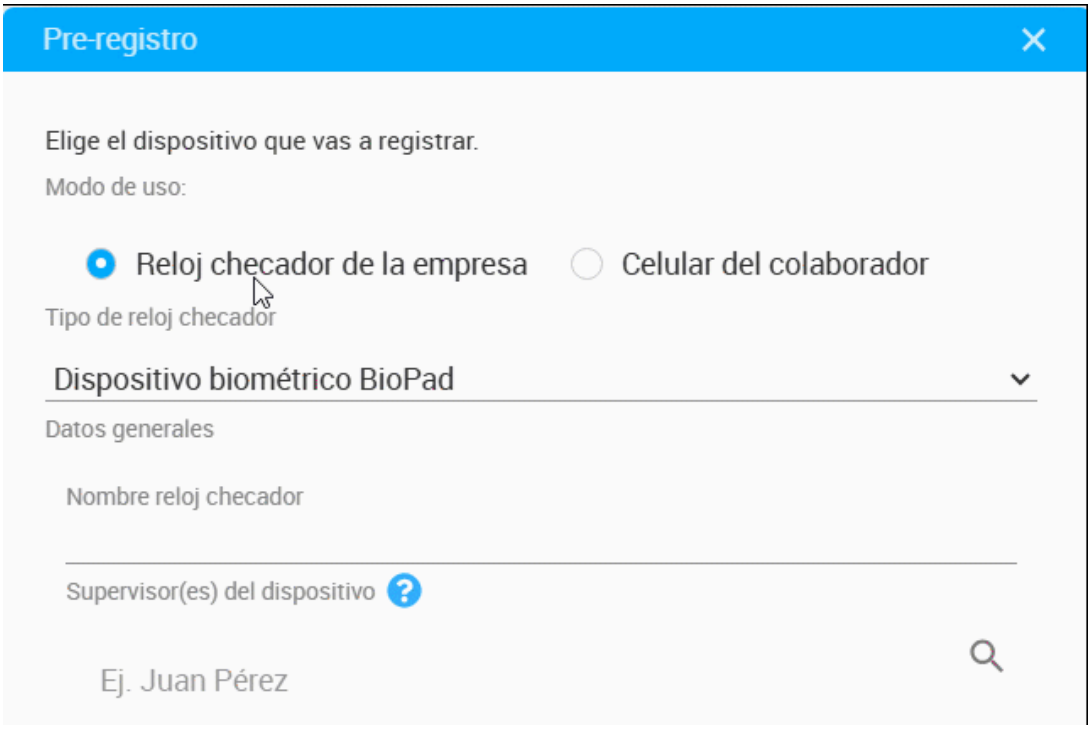

Captura la información solicitada:

- **Nombre del reloj checador:** asigna un nombre para identificar el dispositivo.
- **Supervisor(es) del dispositivo:** selecciona a las personas responsables del equipo.
- **Zona horaria:** indica la correspondiente a la ubicación donde se utilizará.
- **Oficina(s):** elige las oficinas que estarán relacionadas con el BioPad.

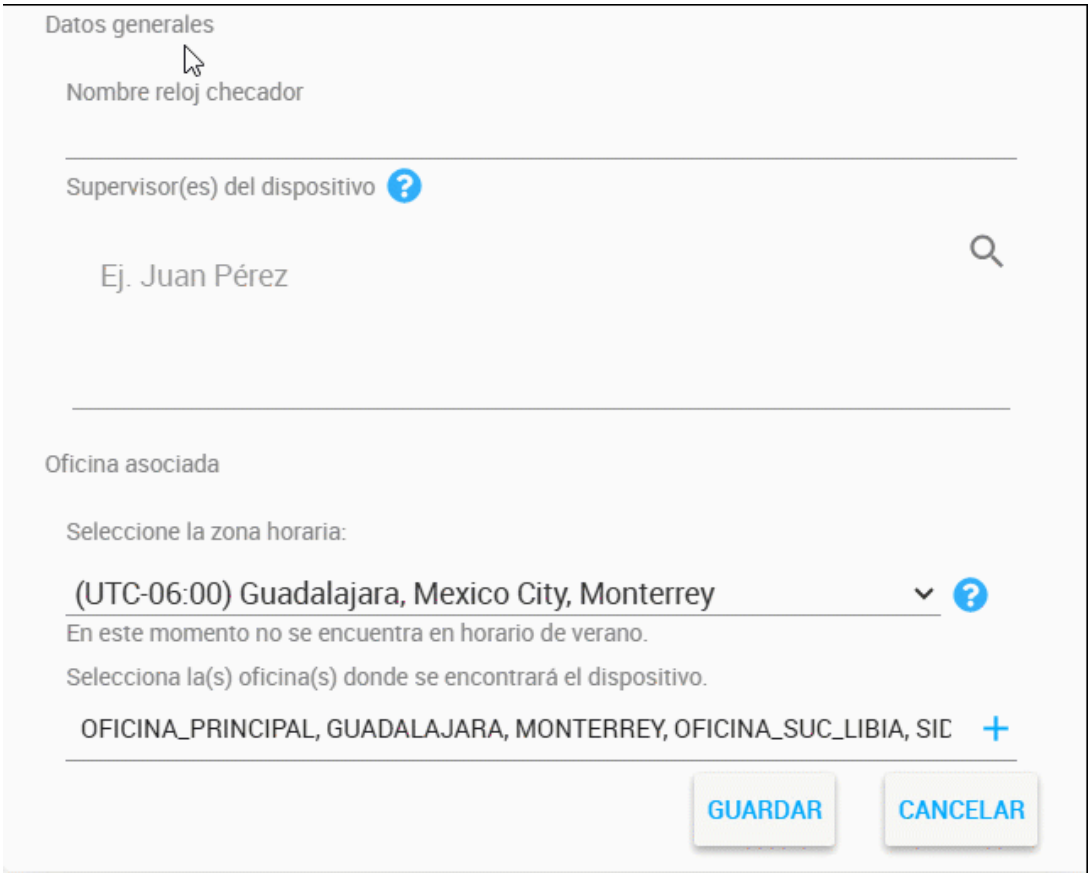

Haz clic en **Guardar** 

para completar el preregistro.

Importante: las oficinas disponibles dependerán de la zona horaria seleccionada.

2. Configura la conexión de red

Conecta el BioPad a una **red de área local (LAN)** y asígnale una **dirección de Protocolo de Internet (IP) fija** para mantener estable la comunicación con Siigo NOI Asistente.



3. Configura la dirección de CallBack

Desde el BioPad, ingresa a **Configurar**, selecciona **General**, después **Configuración del sistema**, abre **Comunicación** y elige **Dirección de CallBack**.

Captura la siguiente dirección:

https://noiasistencia.aspel.com.mx

Nota: esta dirección permite establecer la comunicación entre el dispositivo y Siigo NOI Asistente.


4. Activa el dispositivo

Dirígete al módulo **Biométricos** 

, selecciona **Dispositivos** y localiza el BioPad preregistrado.




En la columna **Operaciones**, haz clic en **Activar** .

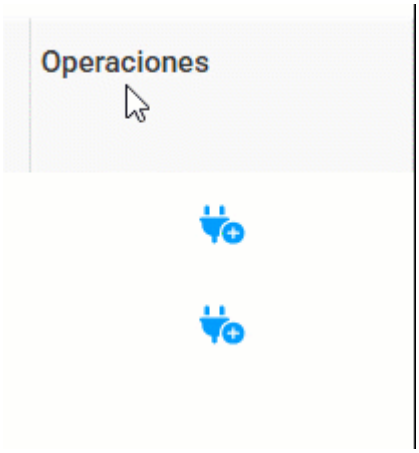

Captura los siguientes datos:

- **IP:** ingresa la dirección fija asignada al dispositivo.
- **Contraseña:** escribe la clave configurada en el BioPad.

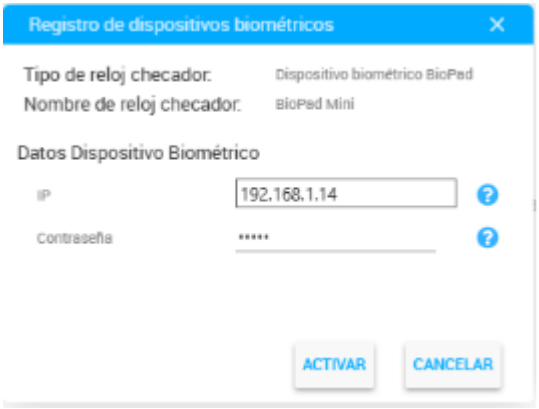



Haz clic en **Activar**  para completar el proceso.

5. Verifica la conexión

En la columna **Operaciones**, selecciona la opción disponible para comprobar que la comunicación entre el BioPad y Siigo NOI Asistente se realice correctamente.

Si la conexión es correcta, el sistema mostrará un mensaje indicando que el dispositivo se encuentra en línea y funcionando correctamente.

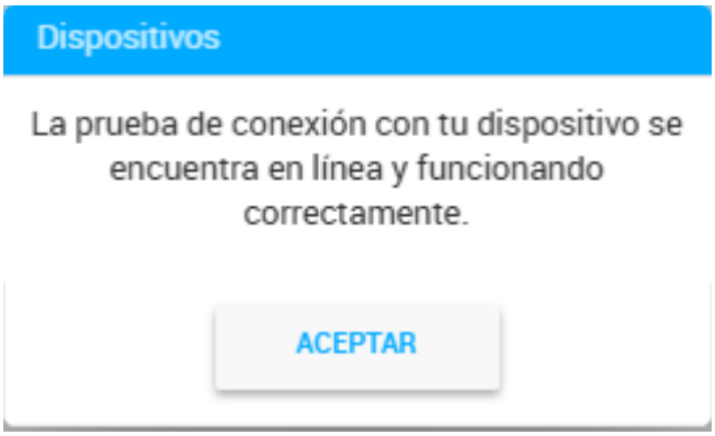

Haz clic en **Aceptar**  para cerrar la notificación y continuar con el proceso para sincronizar empleados con un dispositivo BioPad desde la versión web.

¡Bien hecho! Configurar un dispositivo BioPad con Siigo NOI Asistente desde la versión web permite dejarlo listo para registrar asistencias y dar seguimiento a la información de los empleados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com